



## RESULTADOS – ANO 2012

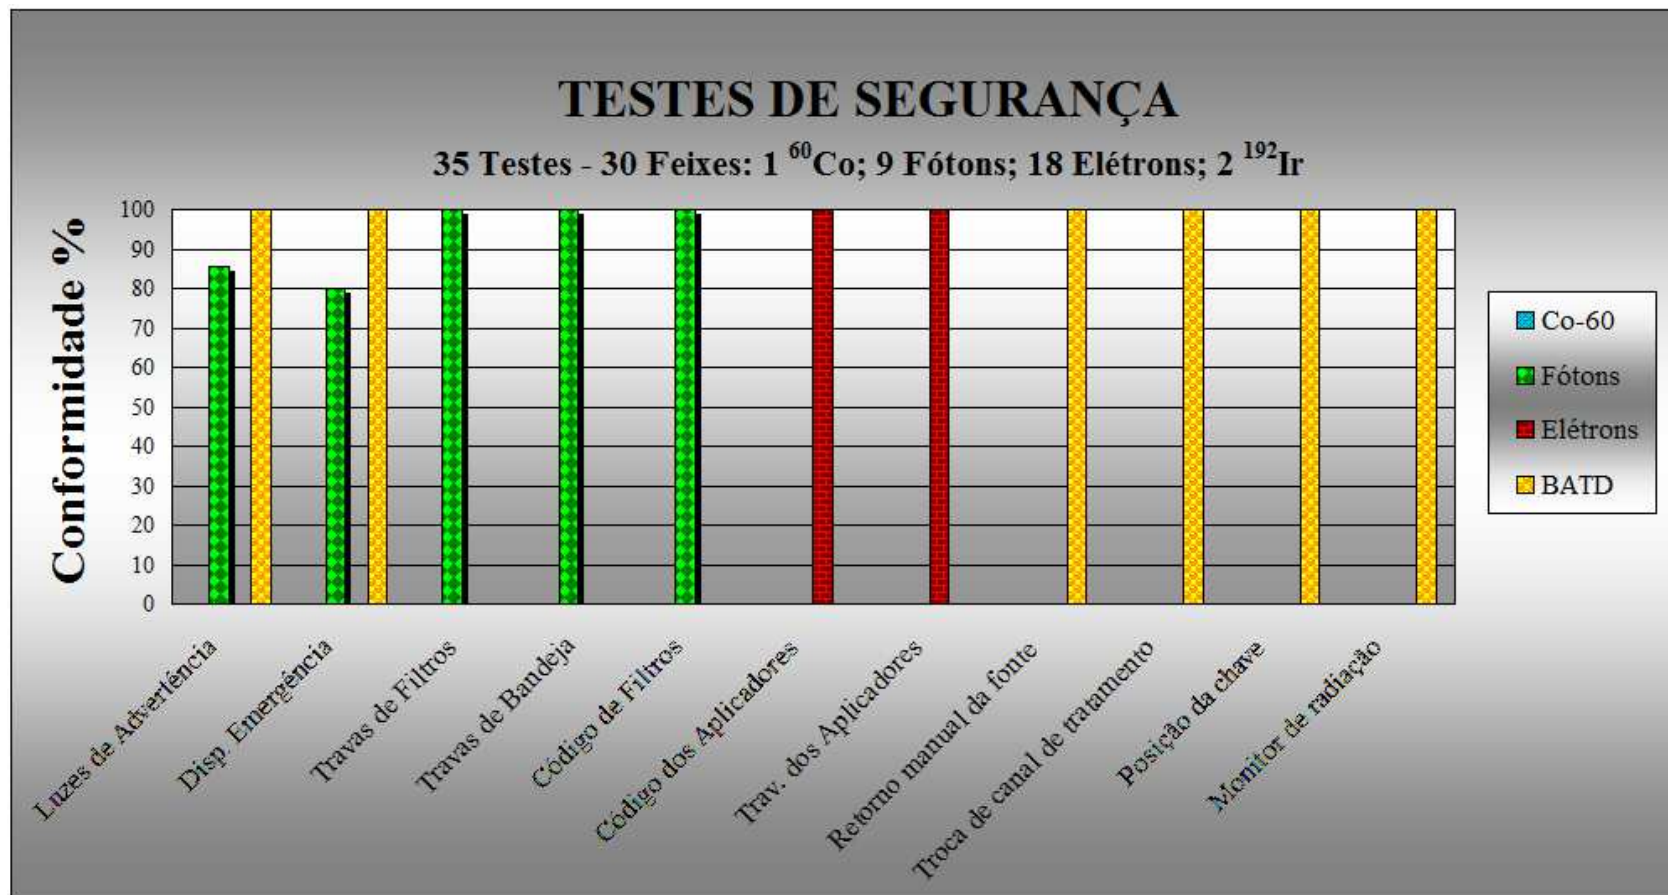

# TESTES MECÂNICOS E ELÉTRICOS


40 Testes - 30 Feixes: 1 <sup>60</sup>Co; 9 Fótons; 18 Elétrons; 2 <sup>192</sup>Ir

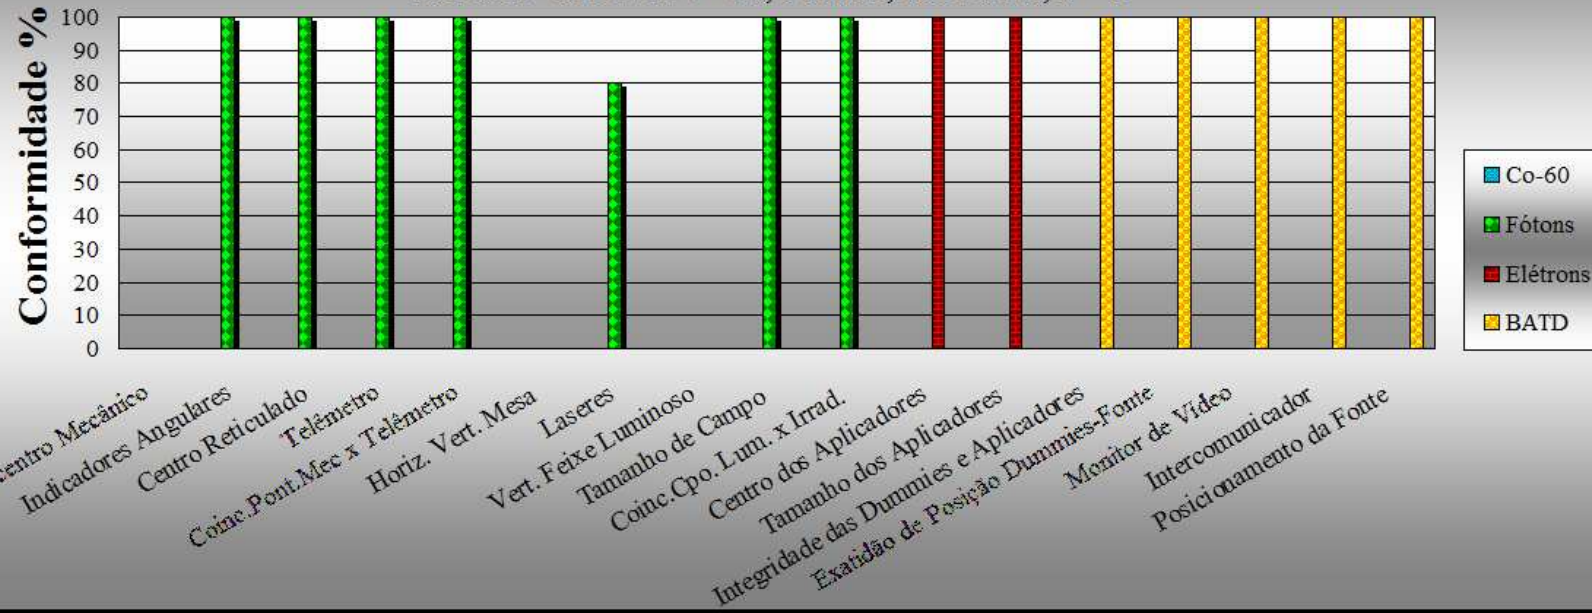

## TESTES DOSIMÉTRICOS

143 Testes - 39 Feixes: 1 <sup>60</sup>Co; 9 Fótons; 18 Elétrons; 2 <sup>192</sup>Ir; 7 IMRT; 1 HET; 1 RDCG

Conformidade %

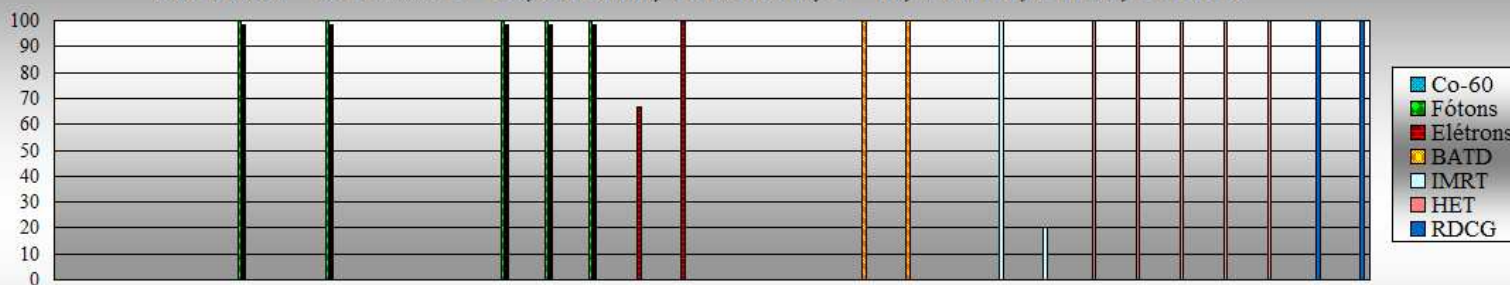

Rep. Temporizador

Lin. Temporizador

Fatores de Campo

Fatores Bandeja

Planura

Isocentro Radiação

Índice de qualidade (TPR20/10)

Índice de qualidade (R50)

Simetria elétrons

Taxa de Kerma no Ar

Intercomparação de câmaras poço

Índice Gamma

Dose no Pulmão

Dose no Osso

Dose no campo 2x5

- Co-60
- Fótons
- Elétrons
- BAID
- IMRT
- HET
- RDCG